


DÉLKA
145 cm

NUTRISON ADVANCED PEPTISORB

OLIGOMERNÍ SONDOVÁ VÝŽIVA
PRO PACIENTY S VÁŽNOU
PORUCHOU TRÁVENÍ A/NEBO
ABSORPCE:

- S deficitem produkce pankreatických enzymů
(pankreatitida, rakovina pankreasu, cystická fibróza, resekce pankreasu)
- Se zánětlivým onemocněním střev
(radiační enteritida, IBD)
- S intolerancí polymerní výživy

Peptidová sondová výživa na bázi
hydrolyzátu syrovátkové bílkoviny,
s nízkým obsahem tuků, s obsahem
MCT. Bez vlákniny.



ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ:

	APA	EAN	KORP. KÓD
Nutrison Advanced Peptisorb 1000 ml	229 914 8	8 712 400 156 875	65 687
Flocare® Bengmark® Tube CH10-145 cm ENFit™	340 394 7	8 716 900 567 032	594 825
Flocare® Bengmark® Tube CH8-145 cm ENFit™	340 400 2	8 716 900 567 018	594 824

Reference:

1. Puiggrós C, Molinos R, Ortiz MD, et al. Experience in bedside placement, clinical validity, and cost-efficacy of a self-propelled nasojejunal feeding tube. *Nutr Clin Pract*. 2015; 30(6):815–23.
2. Lv B, Hu L, Chen L, et al. Blind bedside postpyloric placement of spiral tube as rescue therapy in critically ill patients: a prospective, trisentric, observational study. *Crit Care*. 2017 Sep 26; 21(1):248. doi: 10.1186/s13054-017-1839-2.
3. Vaswani SK. Endoscopic nasoenteral feeding tube placement following cardiothoracic surgery. *Am Surgeon* 1996; 5:421-423.
4. Patrick PG, et al. Endoscopic nasogastric-jejunal feeding tube placement in critically ill patients. *Gastroint Endosc* 1997; 45:72-76.
5. Payne-James J (ed). In: Artificial nutrition support in clinical practice. 1995: chapt 14; ISBN 0-340-56760-0.
6. Jeppsson B, et al. A new self-propelling nasoenteric feeding tube. *Clin Nutrition* 1992; 11:1-3.

Přípravek Nutrison Advanced Peptisorb je potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely pro řízenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí, především u nemocných s těžce porušenou trávicí a vstřebávací funkcí zažívacího ústrojí. **Flocare® Bengmark® Tube** je zdravotnický prostředek určený k podávání enterální výživy. Materiál je určen pouze pro odbornou veřejnost – není určen pro pacienty ani širokou veřejnost. Více informací na obalech výrobků.

Distribuce v ČR:

Nutricia a.s.
V parku 2294/2, 148 00 Praha 4 - Chodov
Infolinka: 800 110 001
Nutricia a.s.

VÝŽIVA
DO JEJUNA

NUTRICIA
flocare®
Bengmark® TUBE

DLOUHÁ NASOJEJUNÁ SONDA K ZAVEDENÍ I BEZ E


NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION

TUBE20HSGASC12Z

SPONTÁNNÍ MIGRACE

Flocare® Bengmark® umožňuje spontánní pasáž sondy z žaludku hluboko do jejunu.

MOTILITA ŽALUDKU

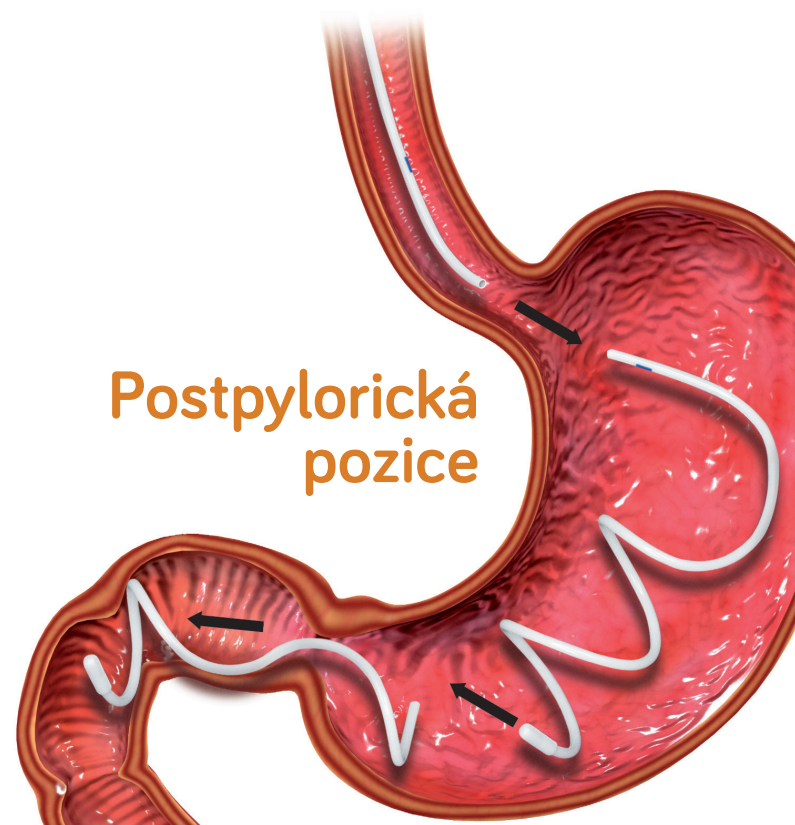

Více než **80% úspěšnost** zavedení¹

USNADNĚTE SOBĚ I PACIENTŮM ZAVÁDĚNÍ NASOJEJUNÁLNÍ SONDY

Flocare® Bengmark® je speciální **dlouhá** nasojejunální sonda, u níž nebudete potřebovat endoskop. Má-li pacient zachovanou motilitu žaludku, lze sondu zavést **metodou spontánní migrace** sondy¹. Sondu lze zavést také metodou zavedení naslepo, event. jinými metodami běžně používanými v klinické praxi.²



Šetrnější způsob zavedení pro pacienta¹



Úspora času a nákladů za endoskopický výkon^{1,3}




Vhodná i pro vzrůstově vysoké pacienty

SONDA NEJEN PRO PACIENTY S PANKREATITIDOU

Sonda Flocare® Bengmark® je indikována pacientům s funkčním intestinálním traktem, vyžadujícím postpylorické živění. Zejména vhodná pro krátkodobé živění do jejunu, např. u pacientů.^{1,4,5}

- S pankreatitidou
- Se zvýšeným rizikem aspirace, refluxu, zvracení (např. respirační selhání, pneumonie)
- Chirurgickým pacientům v raném pooperačním období (břišní chirurgie, operace mozku, orofaryngeální chirurgie)
- S intolerancí výživy do žaludku (potíže s pasáží potravy ze žaludku v důsledku zánětu, atonie žaludku, gastroparézy)

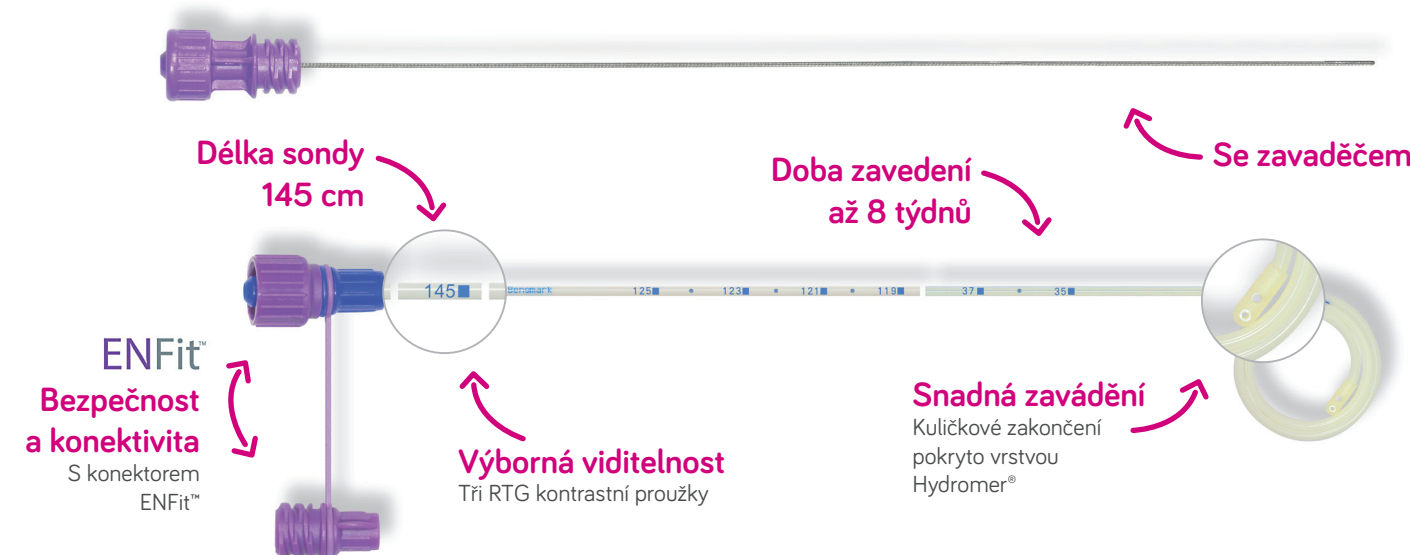

Společnost Nutricia používá výhradně materiály bezpečné a komfortní pro pacienty. Bez obsahu škodlivých ftalátů DEHP.

NUTRICIA
flocare


BEZPEČNÁ FIXACE V JEJUNU

Po fázi zaplávání je sonda Flocare® Bengmark® zafixována v postpylorické pozici díky spirálovému zakončení.⁶

PATENTOVANÁ BENGMARK® SPIRÁLA



přilne ke sliznici jejunu

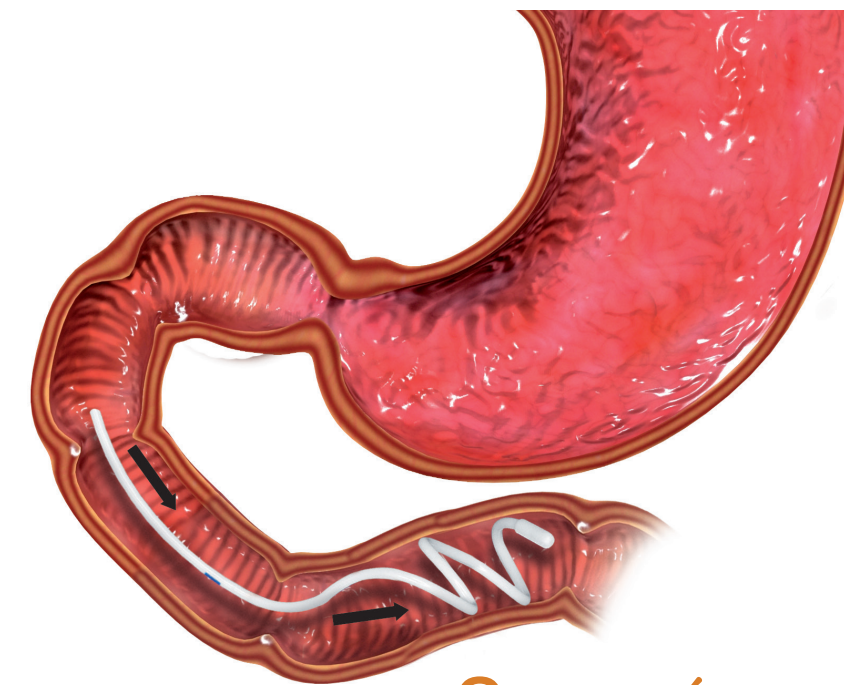

Zachování kontinuity podávání enterální výživy